



Work Gage Metrologia Ltda.

Rua Gravataí, 130 - Centro - Esteio - RS - CEP 93260-010

Fone/Fax: (0xx51) 3473-2087 / 3473-5192

www.workgage.com.br

Laboratório de Metrologia	Certificado n°
Certificado de Calibração	13244/2009

Folha 1/1

Objeto: Micrômetro Externo, com valor de uma divisão de 0,001 mm e capacidade de medição de 0 a 25 mm

N° de autenticação: WG.05.06

Fabricante: Mitutoyo

Modelo: 103-129

Série: 3054689

Cliente: Work Gage Metrologia Ltda.
Rua Gravataí, 130 Esteio - RS

Solicitação: ----

Data da calibração: 7/8/2009

Data da emissão: 07/08/2009

Procedimento: Os procedimentos utilizados para a calibração estão de acordo com o DSQWGM 009-003, rev. 8 de 8/2008.

Equipamentos de Calibração:

- Jogo de Blocos-Padrão Starrett, com certificado de calibração n° RBC 3741/06, emitido por Certi.
Validade: 8/2009
- Jogo de Blocos-Padrão Starrett, com certificado de calibração n° RBC 2394/06, emitido por Starrett.
Validade: 12/2009
- Jogo de Paralelos Óticos Starrett, com certificado de calibração n° RBC 2666 e 41614-1/06, emitido por Cetemp.
Validade: 8/2009


Condições Ambientais: Temperatura: $20 \pm 1^\circ\text{C}$ Umidade Relativa do Ar: entre 35 e 70%

Incerteza de Medição: A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência "k", o qual para uma distribuição t com v_{eff} declarado corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

RESULTADOS OBTIDOS

Parâmetro	Símbolo	Valor Obtido (mm)	Incerteza \pm (mm)	Fator "k"	v_{eff}
Erro máximo de indicação	$f_{\text{máx}}$	0,000	0,002	2,00	>100
Paralel. entre os contatos	-	0,000	0,001	2,00	>100
Planeza do contato fixo	-	0,0003	0,0004	2,00	>100
Planeza do contato móvel	-	0,0003			

GRÁFICO DOS ERROS DE INDICAÇÃO

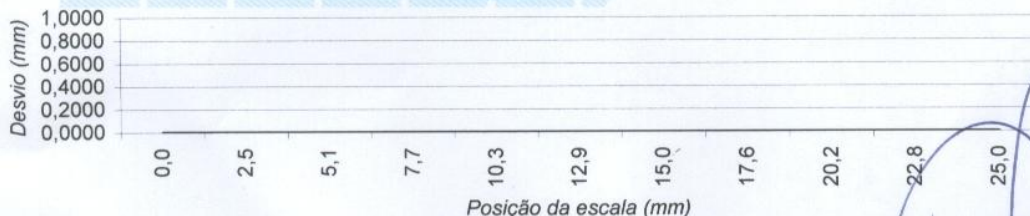

Análise do cliente:	Data: ___/___/___
<input type="checkbox"/> Aprovado	Responsável _____
<input type="checkbox"/> Aprovado condicional	
<input type="checkbox"/> Reprovado	

Sistema de Gestão em conformidade
com a norma
ISO/IEC 17025:2005

<input checked="" type="checkbox"/> Betânia Graebin	_____ Signatário Autorizado
<input type="checkbox"/> Andrews Dieckmann	
<input type="checkbox"/> Antônio Tavares	
<input type="checkbox"/> Jair A. Pimentel	

-Este certificado não tem valor para fins da metrologia legal e se limita exclusivamente ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- A reprodução somente poderá ser feita na sua totalidade e com autorização prévia da Work Gage Metrologia Ltda.
- Qualquer ajuste realizado no equipamento estará registrado no certificado de calibração.
- Os resultados são válidos somente para o estado do objeto no momento da medição.